


► www.mt.com/Thornton-DO

주문 정보

광학식 용존 산소 센서		주문 번호
순수 ISM 광학식 DO 프로브		30 041 040
* 모든 신규 설치에는 센서, 하우징 및 케이블이 필요합니다.		
필요한 액세서리		
순수 스테인리스 스틸 하우징		58 084 018
센서 케이블		
2m		52 300 379
5m		52 300 380
10m		52 300 381
15m		52 206 422
25m		52 206 529
50m		52 206 530
예비 부품		
OptoCap 교체 키트		52 206 403
액세서리		
iSense 정식 버전		30 130 614
iSense lite 버전		무료로 제공
iSense 모바일 버전		무료로 제공
iSense용 iLink 케이블		52 300 399

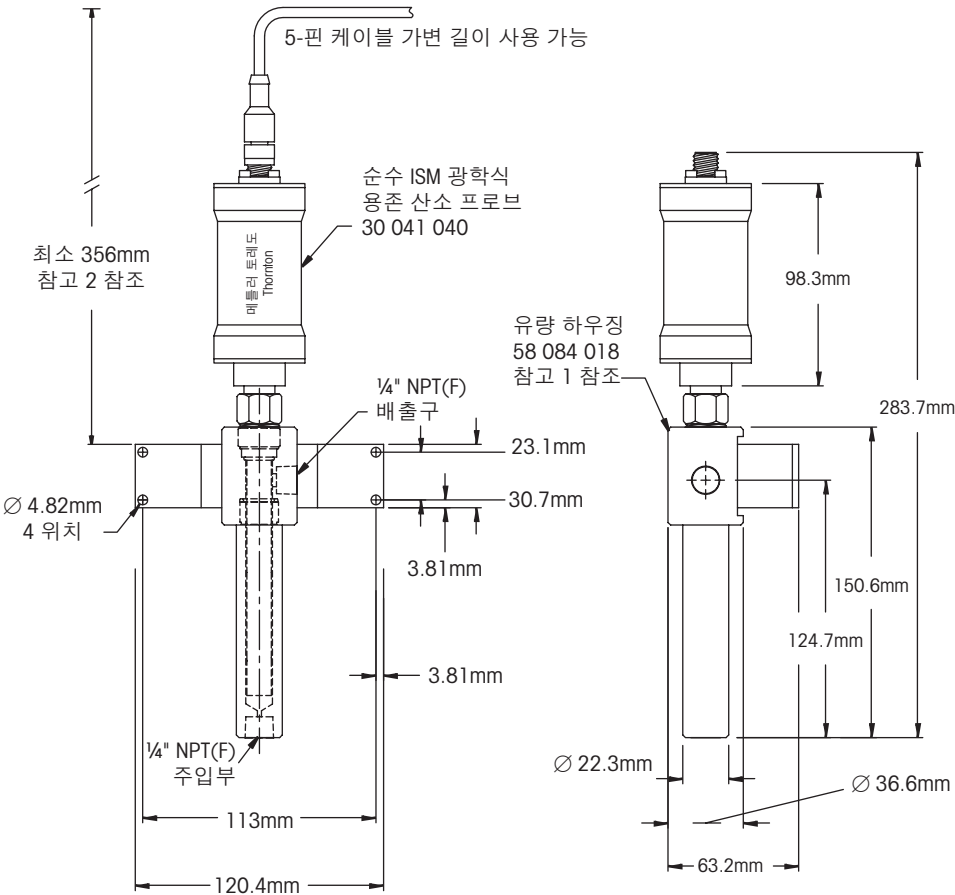

- 참고:**
- 전극/유량 하우징 어셈블리는 그림처럼 세워야 합니다.
 - 356mm 간격을 두어 센서를 제거 하십시오.